




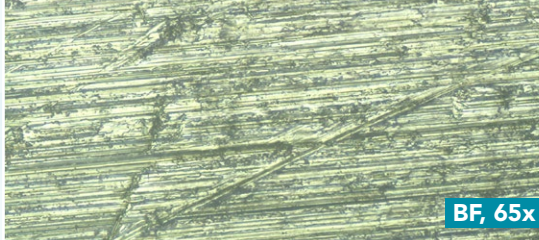





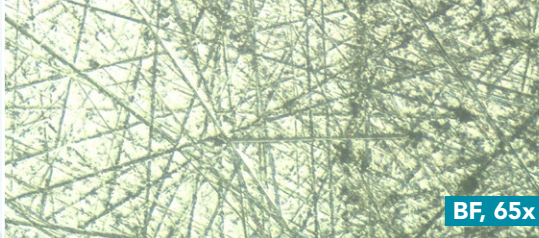





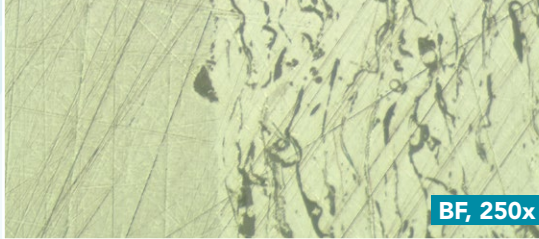





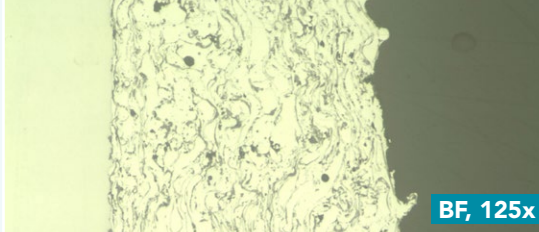


# Aka-Brief #5 Piezas con recubrimiento por Plasma

1						
	Piatto 120	Agua	300 rpm	35 N	Hasta planitud	BF, 65x
2						
	Allegran 9	DiaMaxx Poly 9 µm	150 rpm	35 N	5:00 min	BF, 65x
3						
	Allegran 3	DiaMaxx Poly 3 µm	150 rpm	35 N	5:00 min	BF, 250x
4						
	Daran	Fumed Silica 0.2 µm Alkaline	150 rpm	25 N	2:00 min	BF, 125x

Se indican tiempos para un sistema de preparación de 300 mm. y una muestra individual de diámetro 40 mm.

En un sistema de 250 mm. los tiempos deben incrementarse en un 30%, y en un sistema de 200 mm. en un 100%.

Con muestras más grandes la fuerza debe ser incrementada, con muestras más pequeñas disminuida.

Los tiempos y las fuerzas pueden variar en función del equipo.